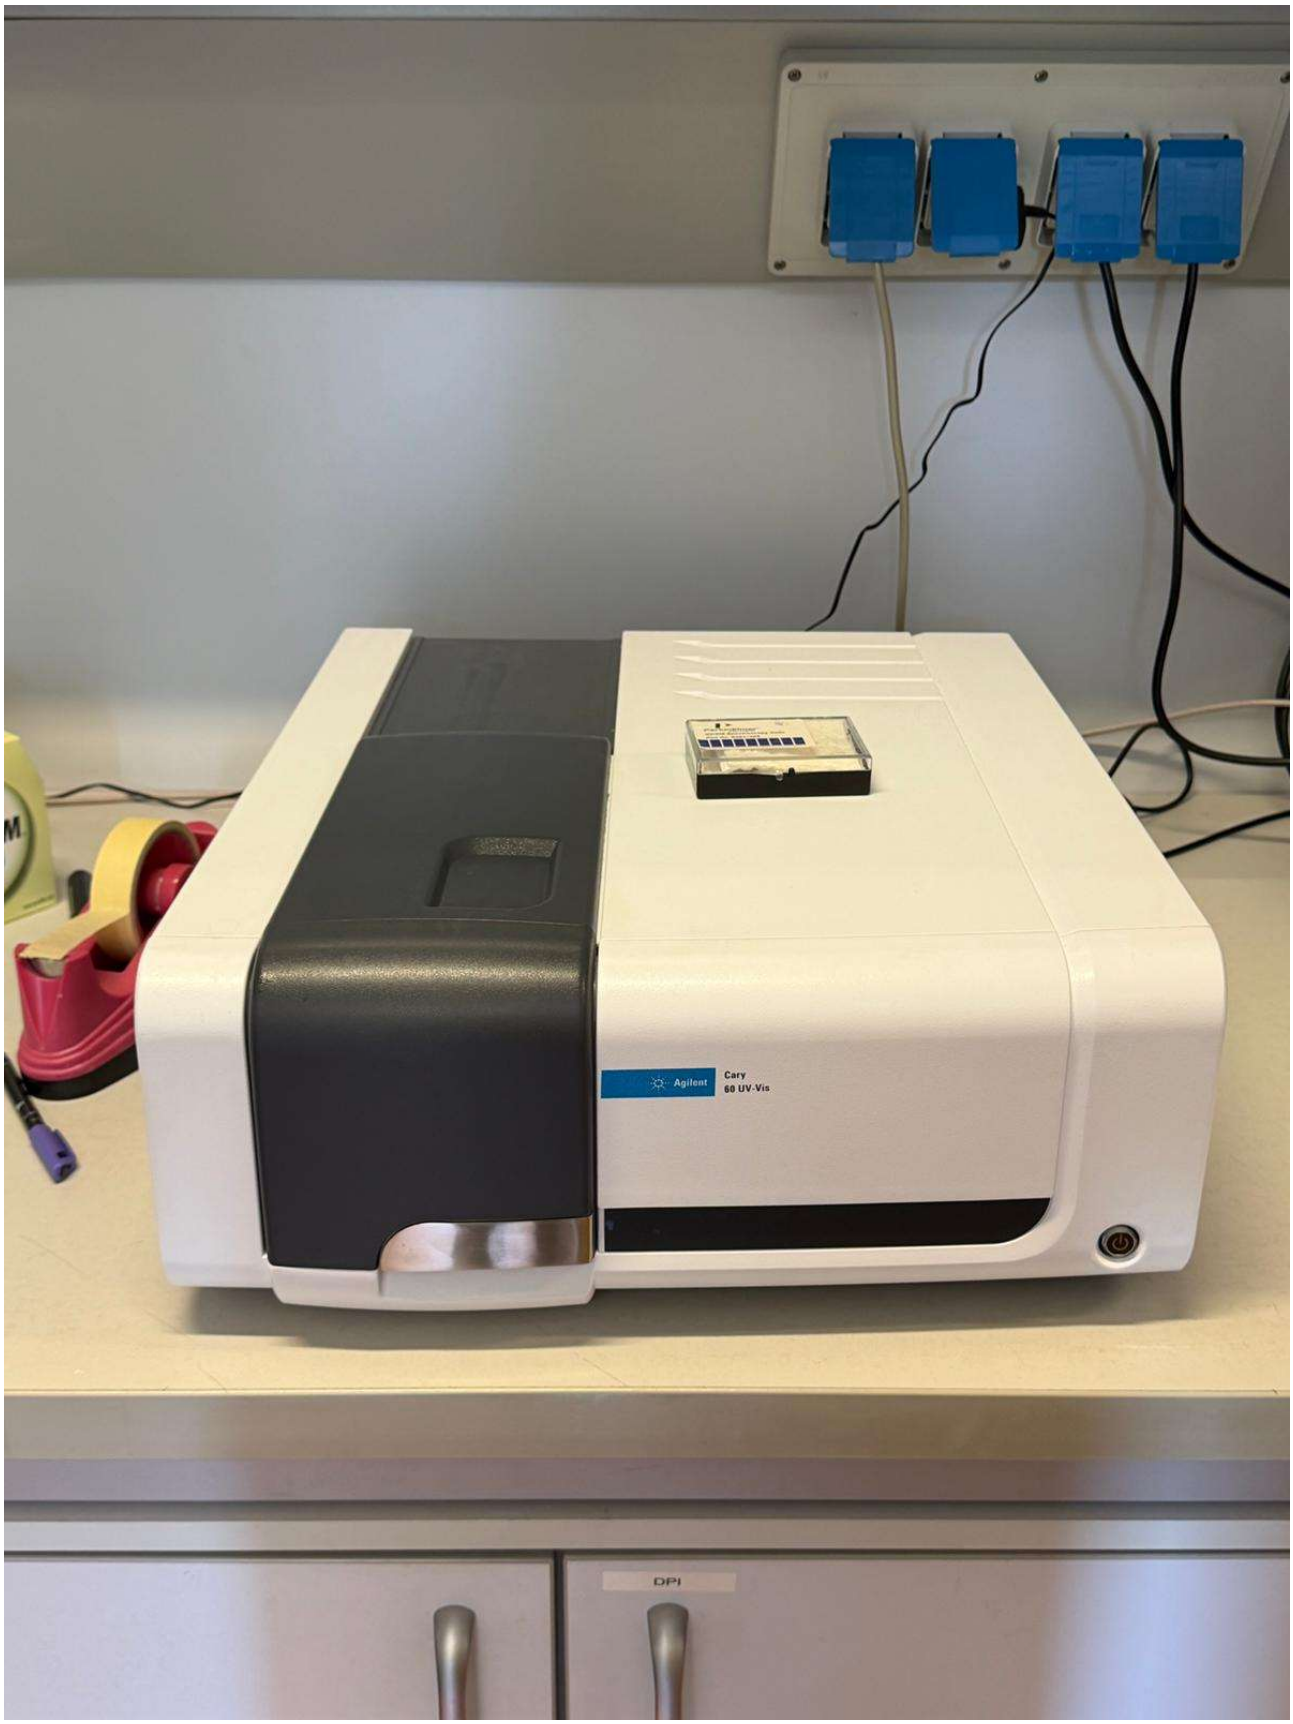
Agilent
Cary
60 UV-Vis
DPI

TOILETTE
CHIUDERE
SEMPRE
QUESTA PORTA

VIETATO FUM
TOILETTE

ologies

Basi
Lauge
Lye
Base
Acidi
Säure
Acid
Acids
MOB.AC./BAS.
SA062
CLORIDRICO
ACIDI
AC.FOSFORICO
AC.NITRICO
AC.SOLFORICO

KW
ALTA TEMPERATURA
ALTA TEMPERATURA

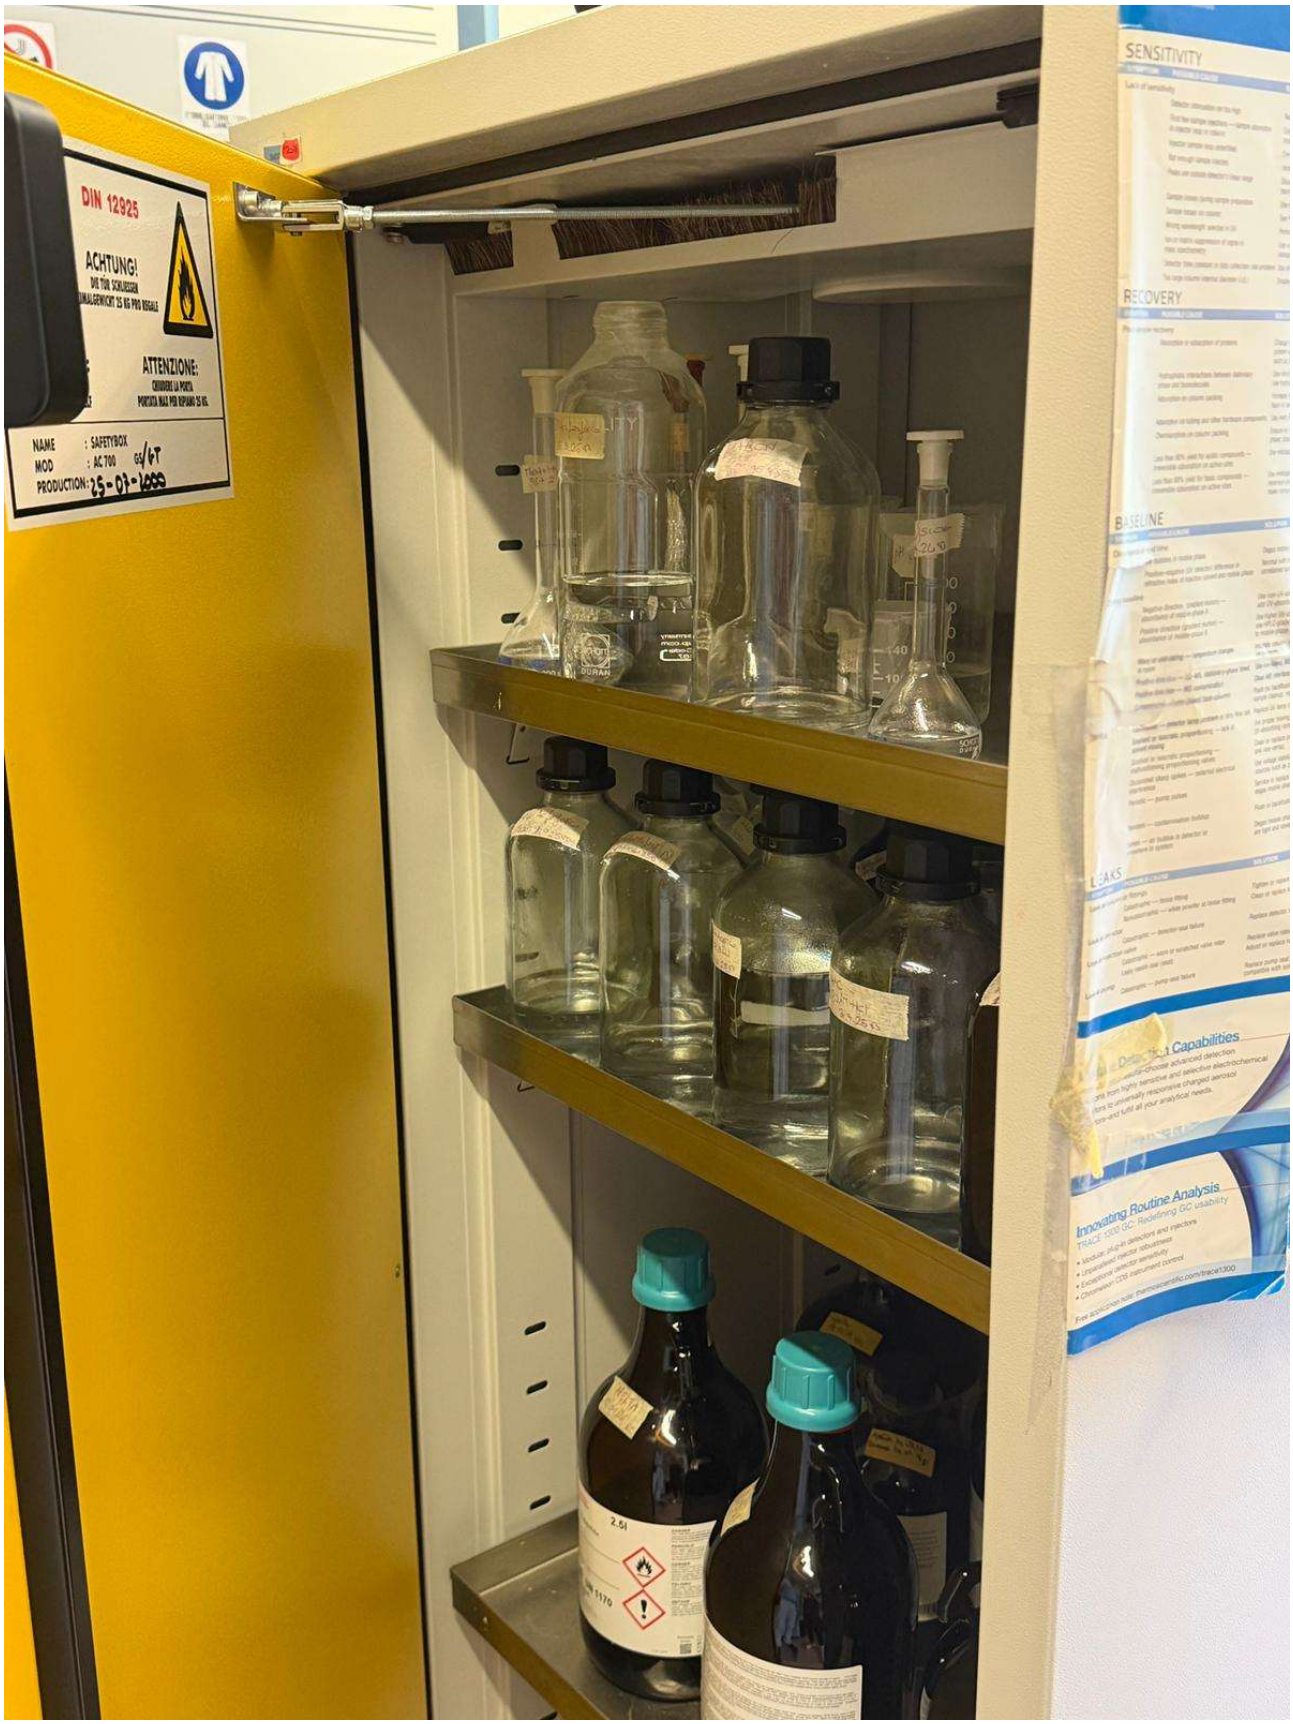
DIN 12925
ACHTUNG!
ATTENZIONE:
NAME : SAFETYBOX
MOD : AC 700
PRODUCTION: 25-03-2020
SENSITIVITY
RECOVERY
BASELINE
LEAKS
Innovating Routine Analysis

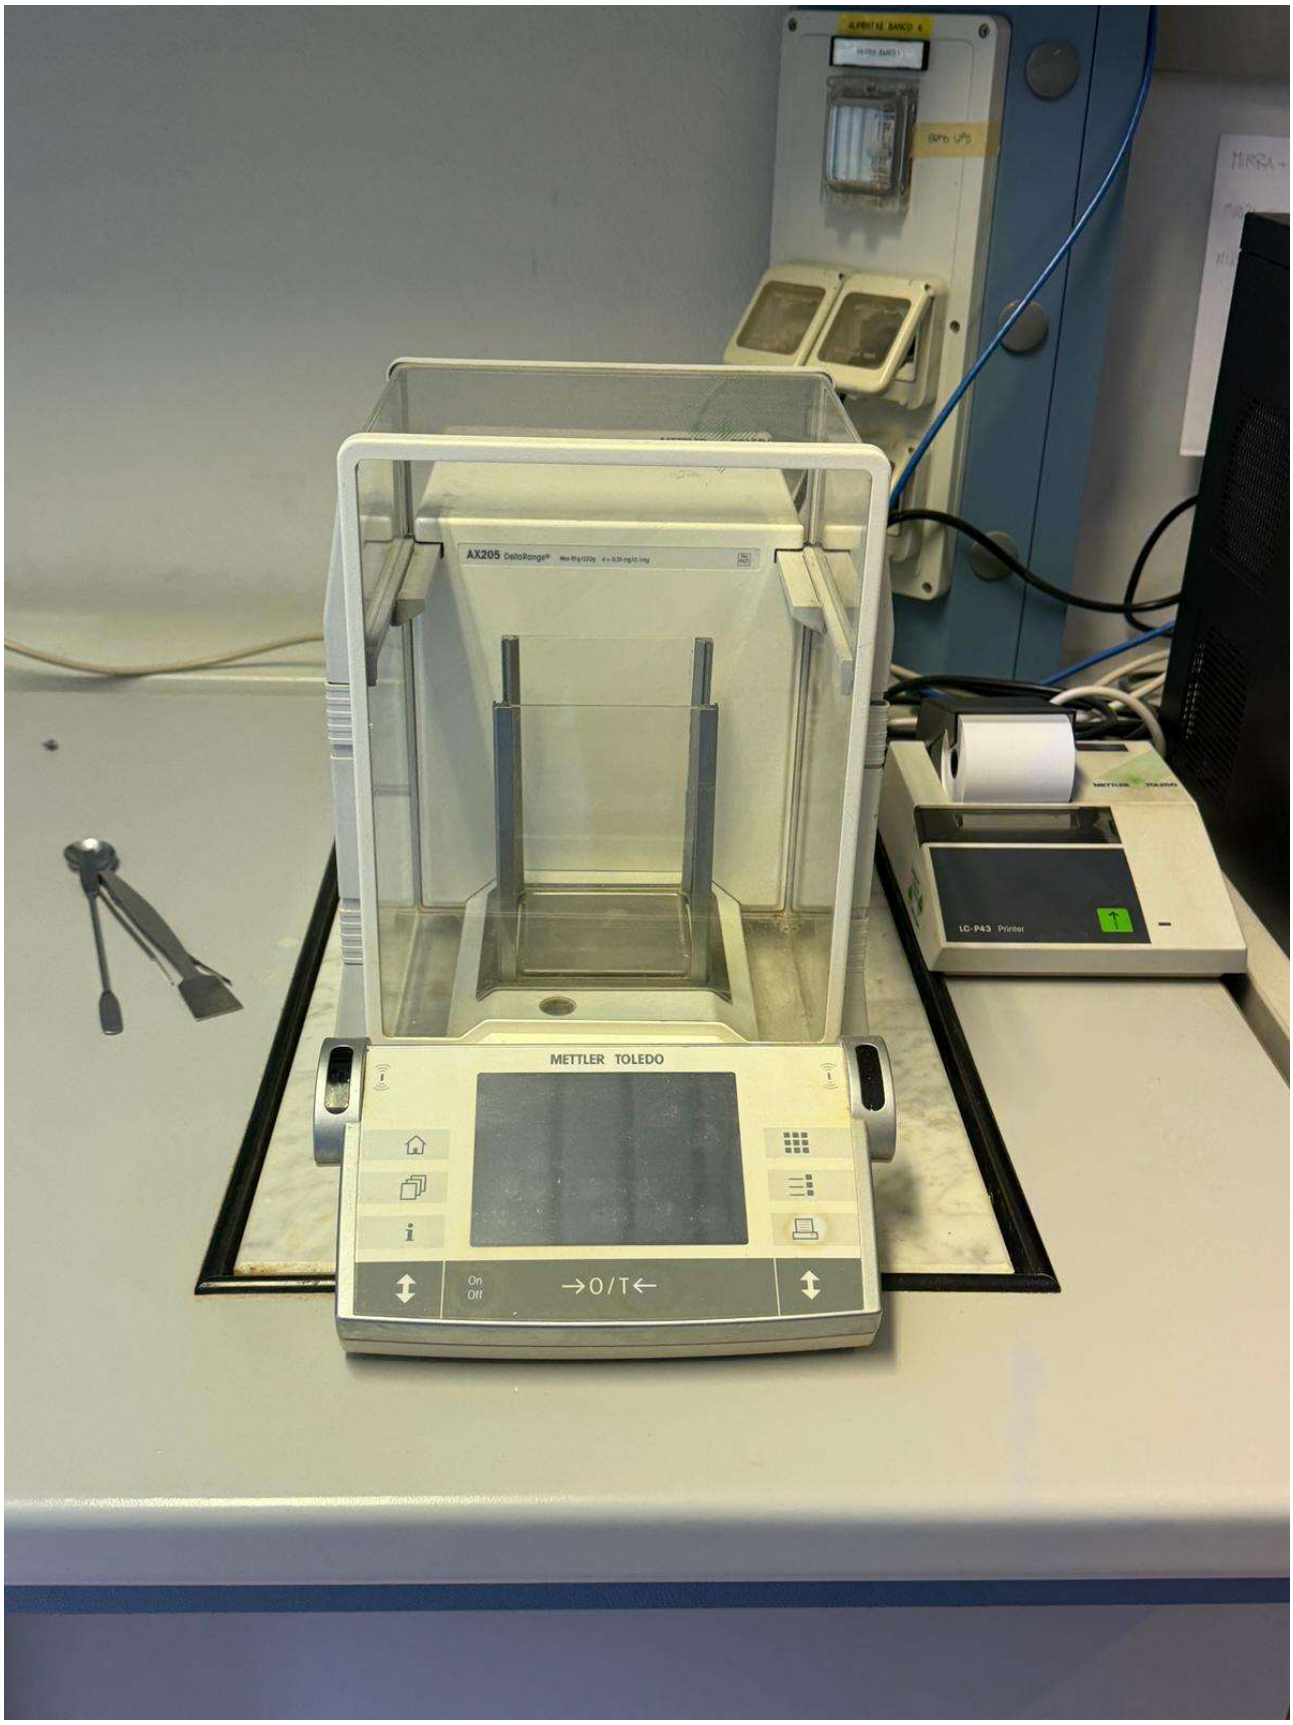
AX205 DeltaRange®
METTLER TOLEDO
LC-P43 Printer
On
Off
→0/T←

STERIL-POWDER SAFE
Compact
SAFETYBOX

atsfaar
S.p.A.
Linea Flex
VIETATO FUMARE
E' OBBLIGATORIO L'USO DEL CAMICE
atsfaar SpA
CAPPA "Linea Flex" MOD.1500
CAPPA DI ASPIRAZIONE CONFORME ALLE NORME
"Tenere lo sportello chiuso tutte le volte che sia possibile"

DRYCE

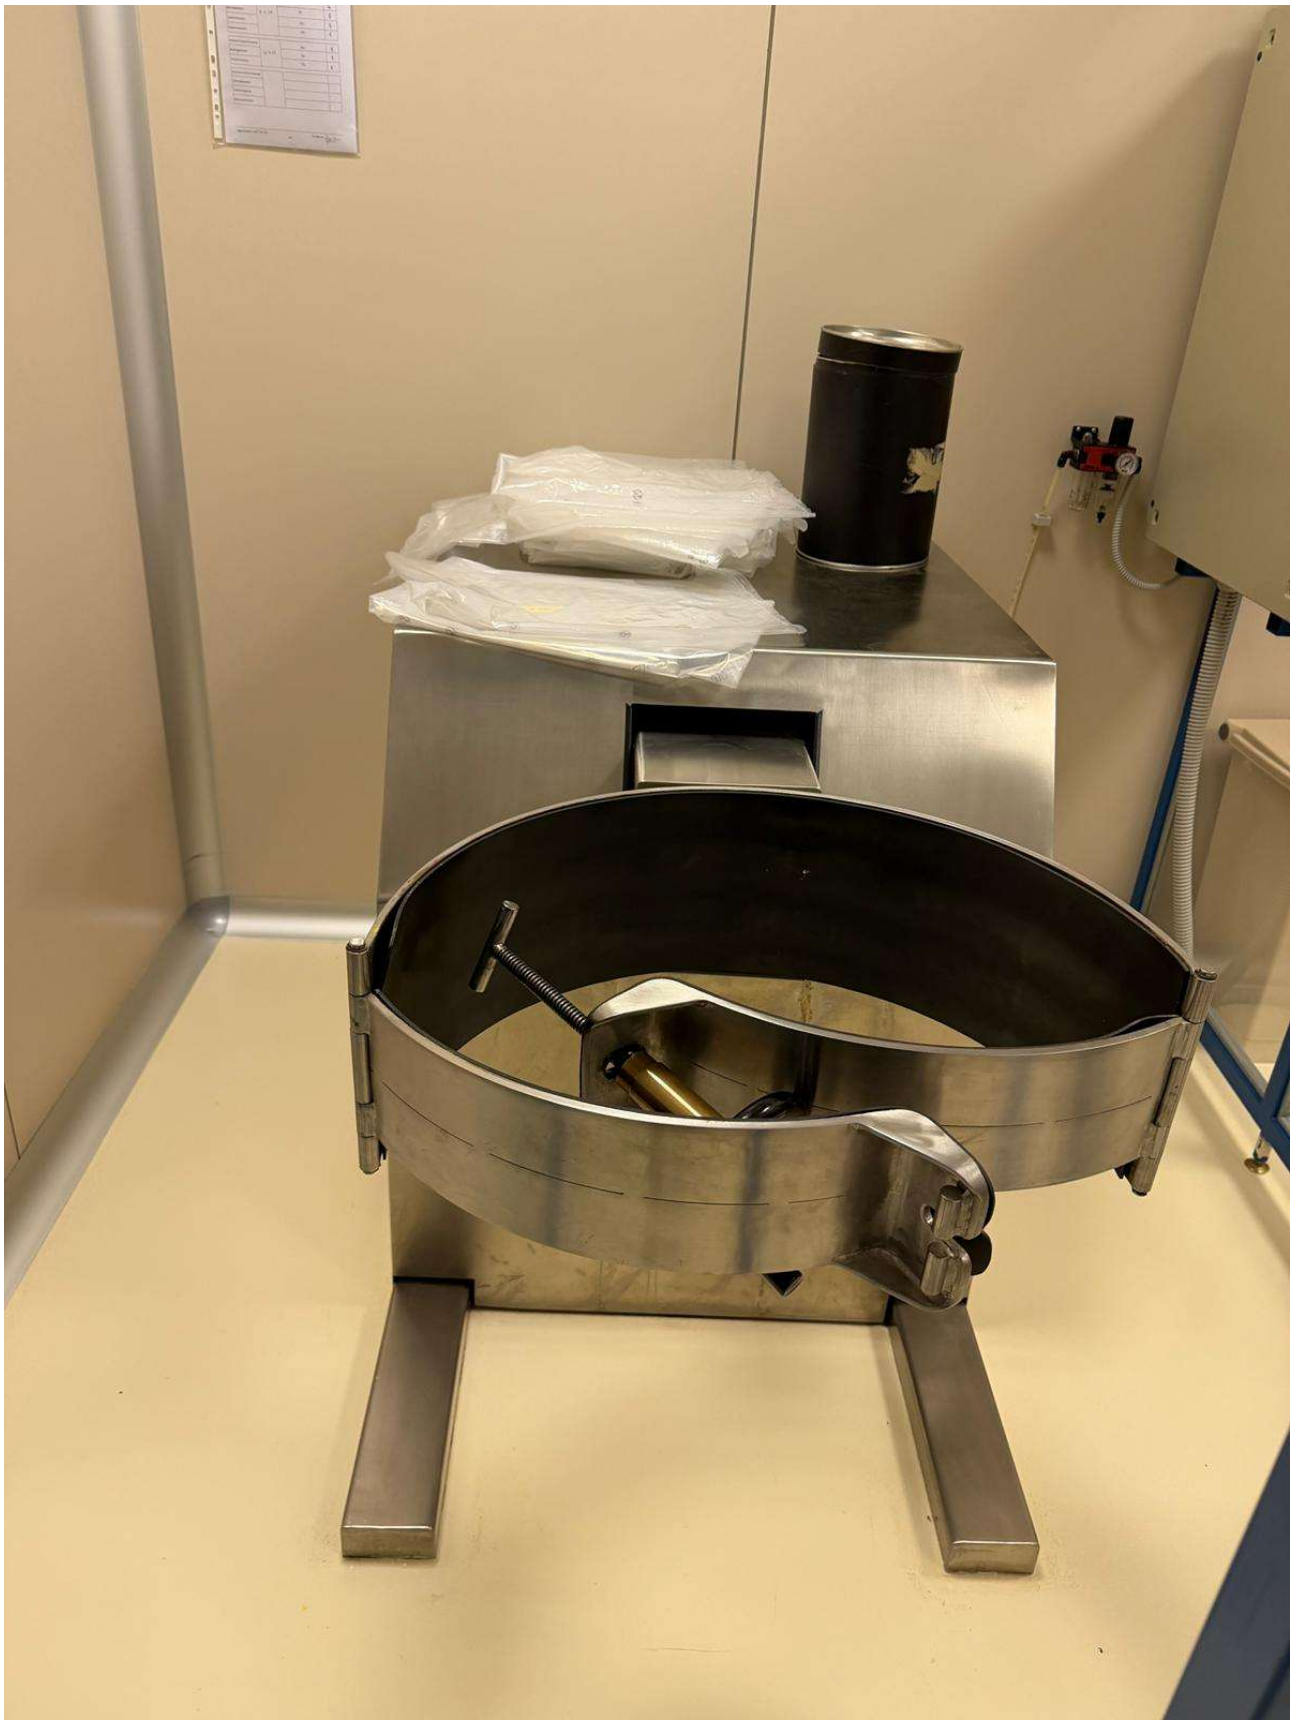

DSC Q100
SAQ48

EX
EX
118
CANVASS
cfm

CAFFÈ
BORBONE
NAPOLI

FXQ
EX
PERICOLO DI ESPLOSIONE
DANGER EXPLOSION

10KVA
On-Line UPS
SINPEG
AE013

Oxford
Agilent Technologies

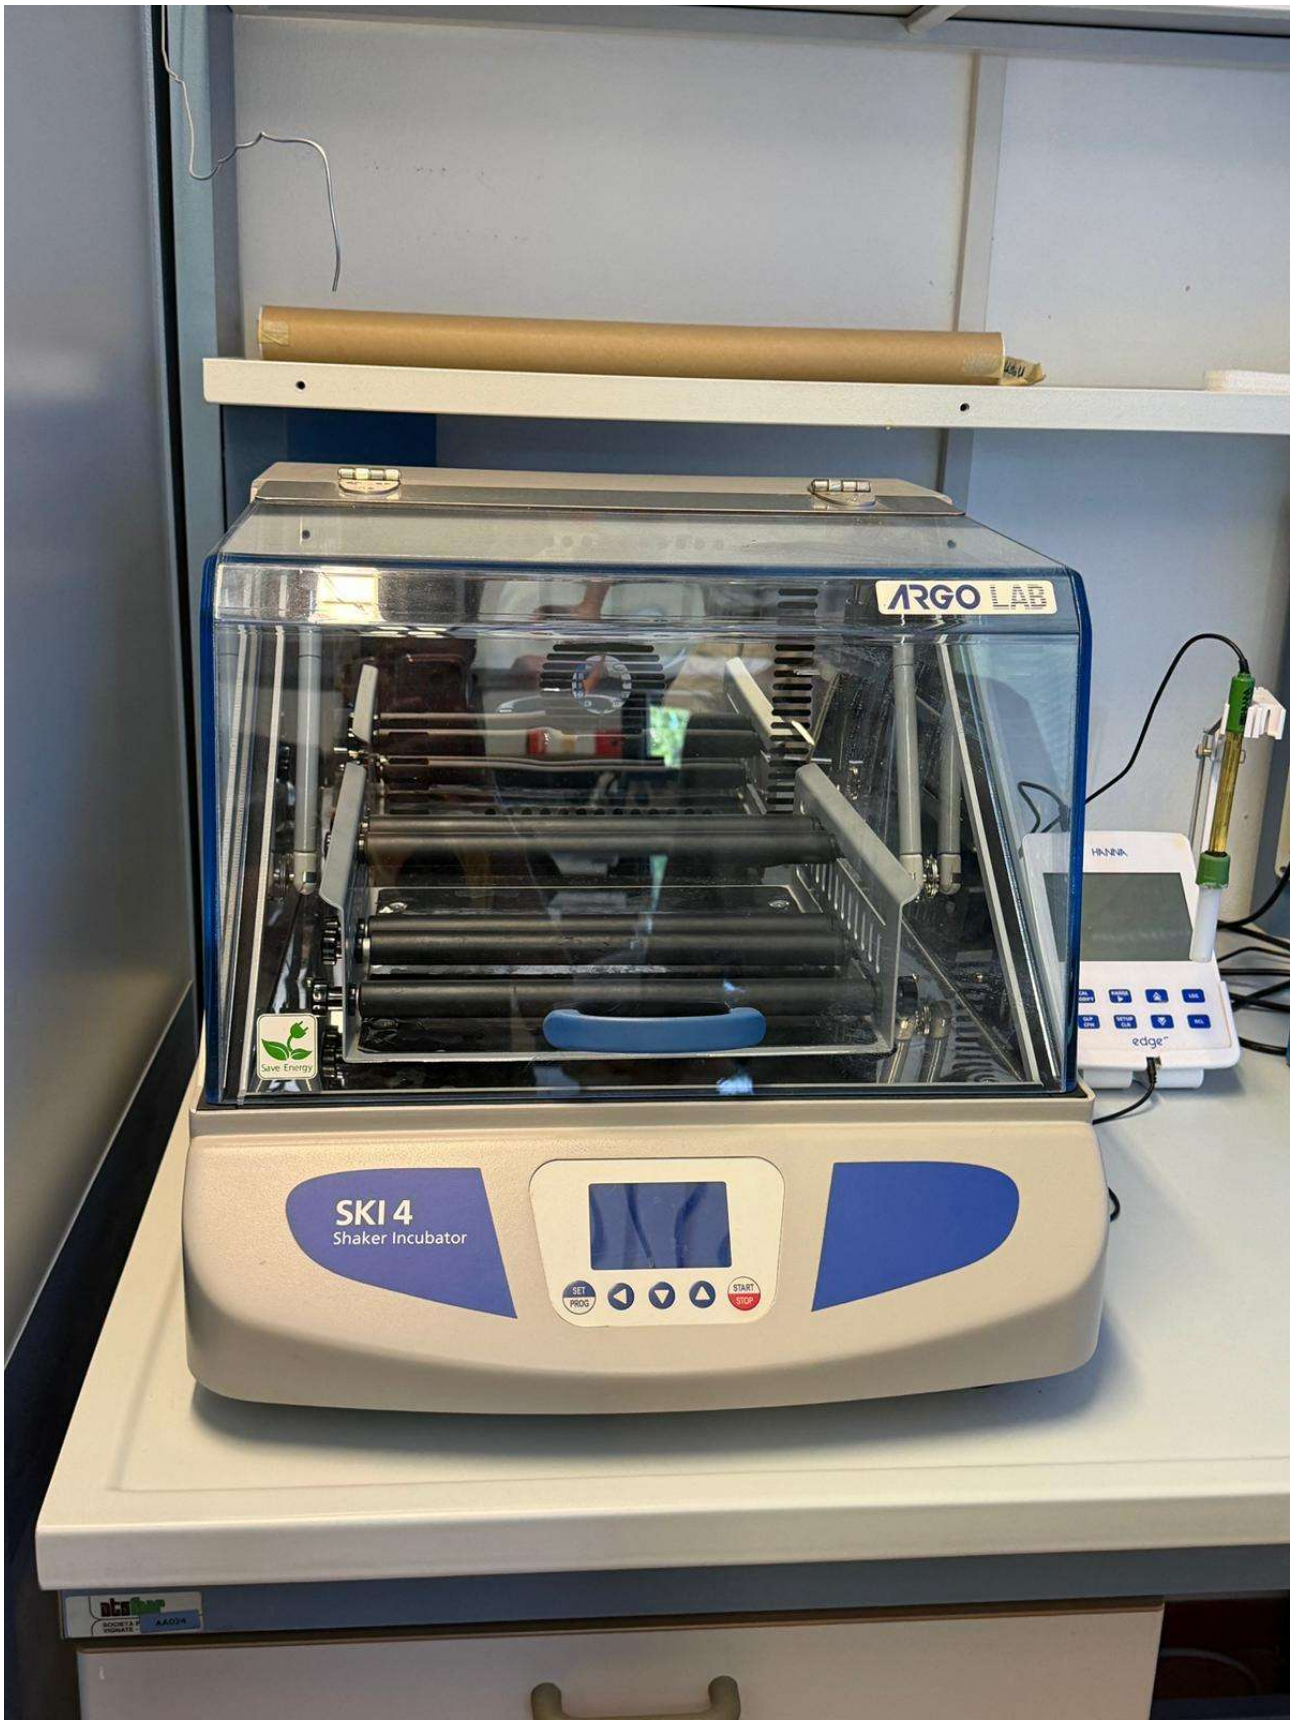
ARGO LAB
Save Energy
SKI 4
Shaker Incubator
SET PROG
START STOP
HANNA
edge

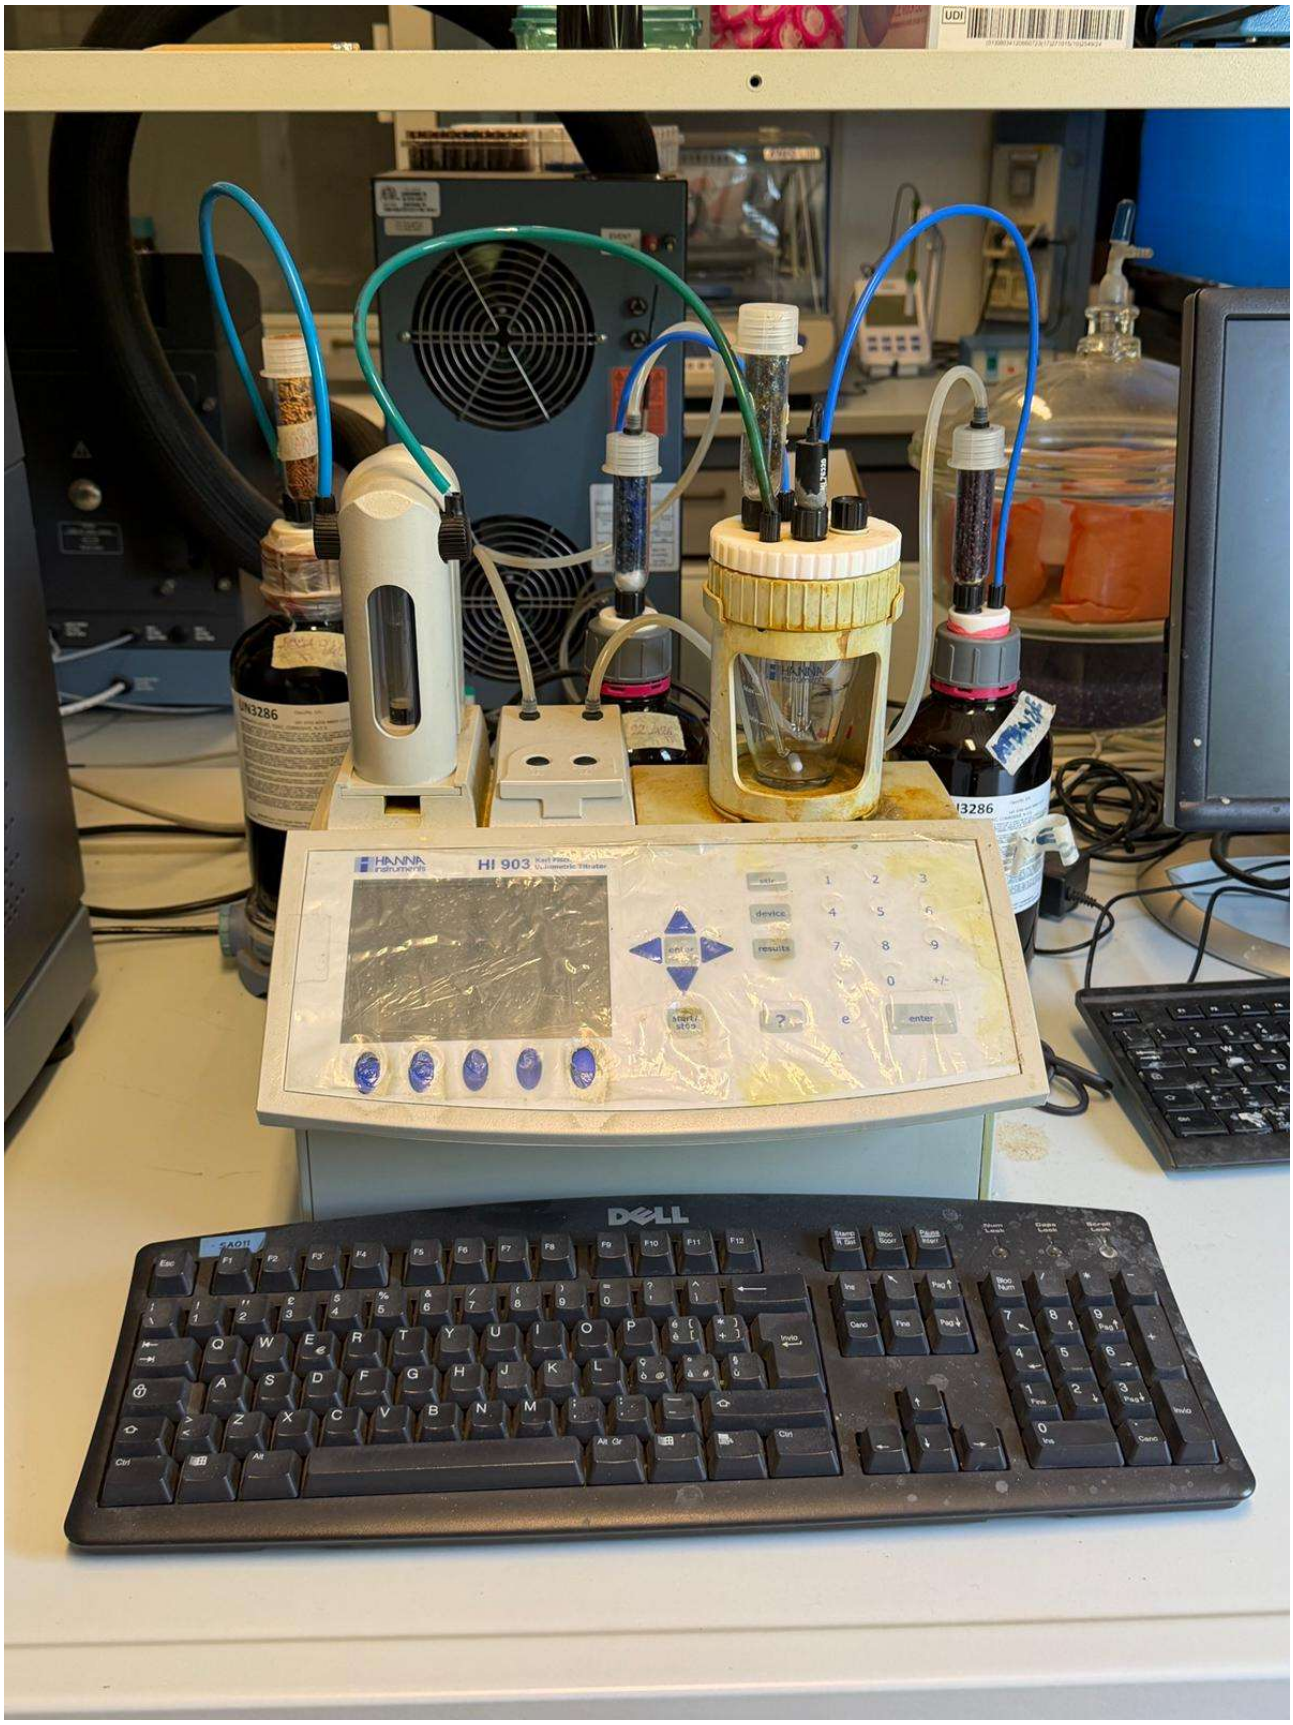
HANNA instruments
HI 903
device
results
enter
DELL

DEST. WASSER

XS, S, M, L : 10x100
XL : 10x 90
AQL 1,5
PARAFILM
PM-996
One Source

PROPAC
rossoreprocopy-document
burgo
PIARDI

ACEF

EX

155061219
30 922
pulverisette 5
START
STOP

atsfaar
Linea Flex
Guide to LC Troubleshooting

POWER SAFE

bbartigrafiche
APRILE 2026
MAGGIO 2026
GIUGNO 2026

EX

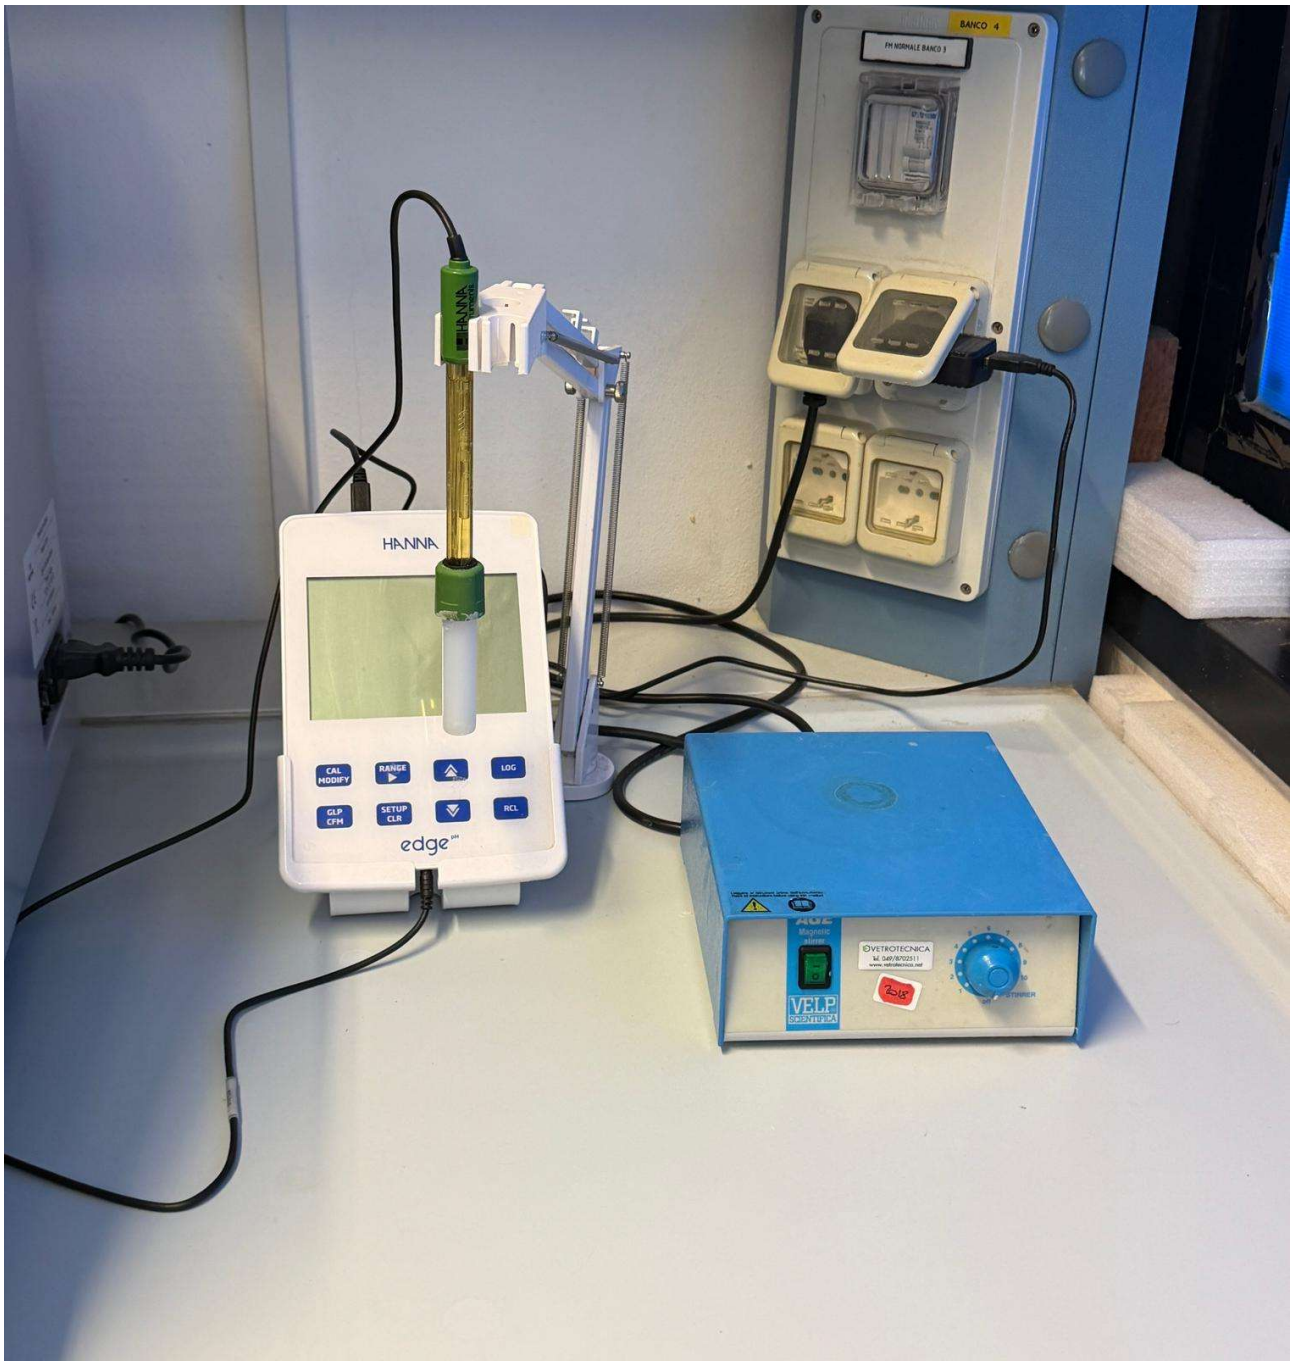
BANCO 4
HANNA
CAL MODIFY
RANGE
LOG
GLP CFM
SETUP CLR
RCL
edge
VETROTECNICA
VELP

QUARANTENA
ARMADIO
CONTROCAMPIONI
PER
CAMPIONATURE

ARMADIO
CONTROCAMPIONI
PER
CAMPIONATURE

THE MERCK INDEX
Pschyrembel Klinisches Wörterbuch

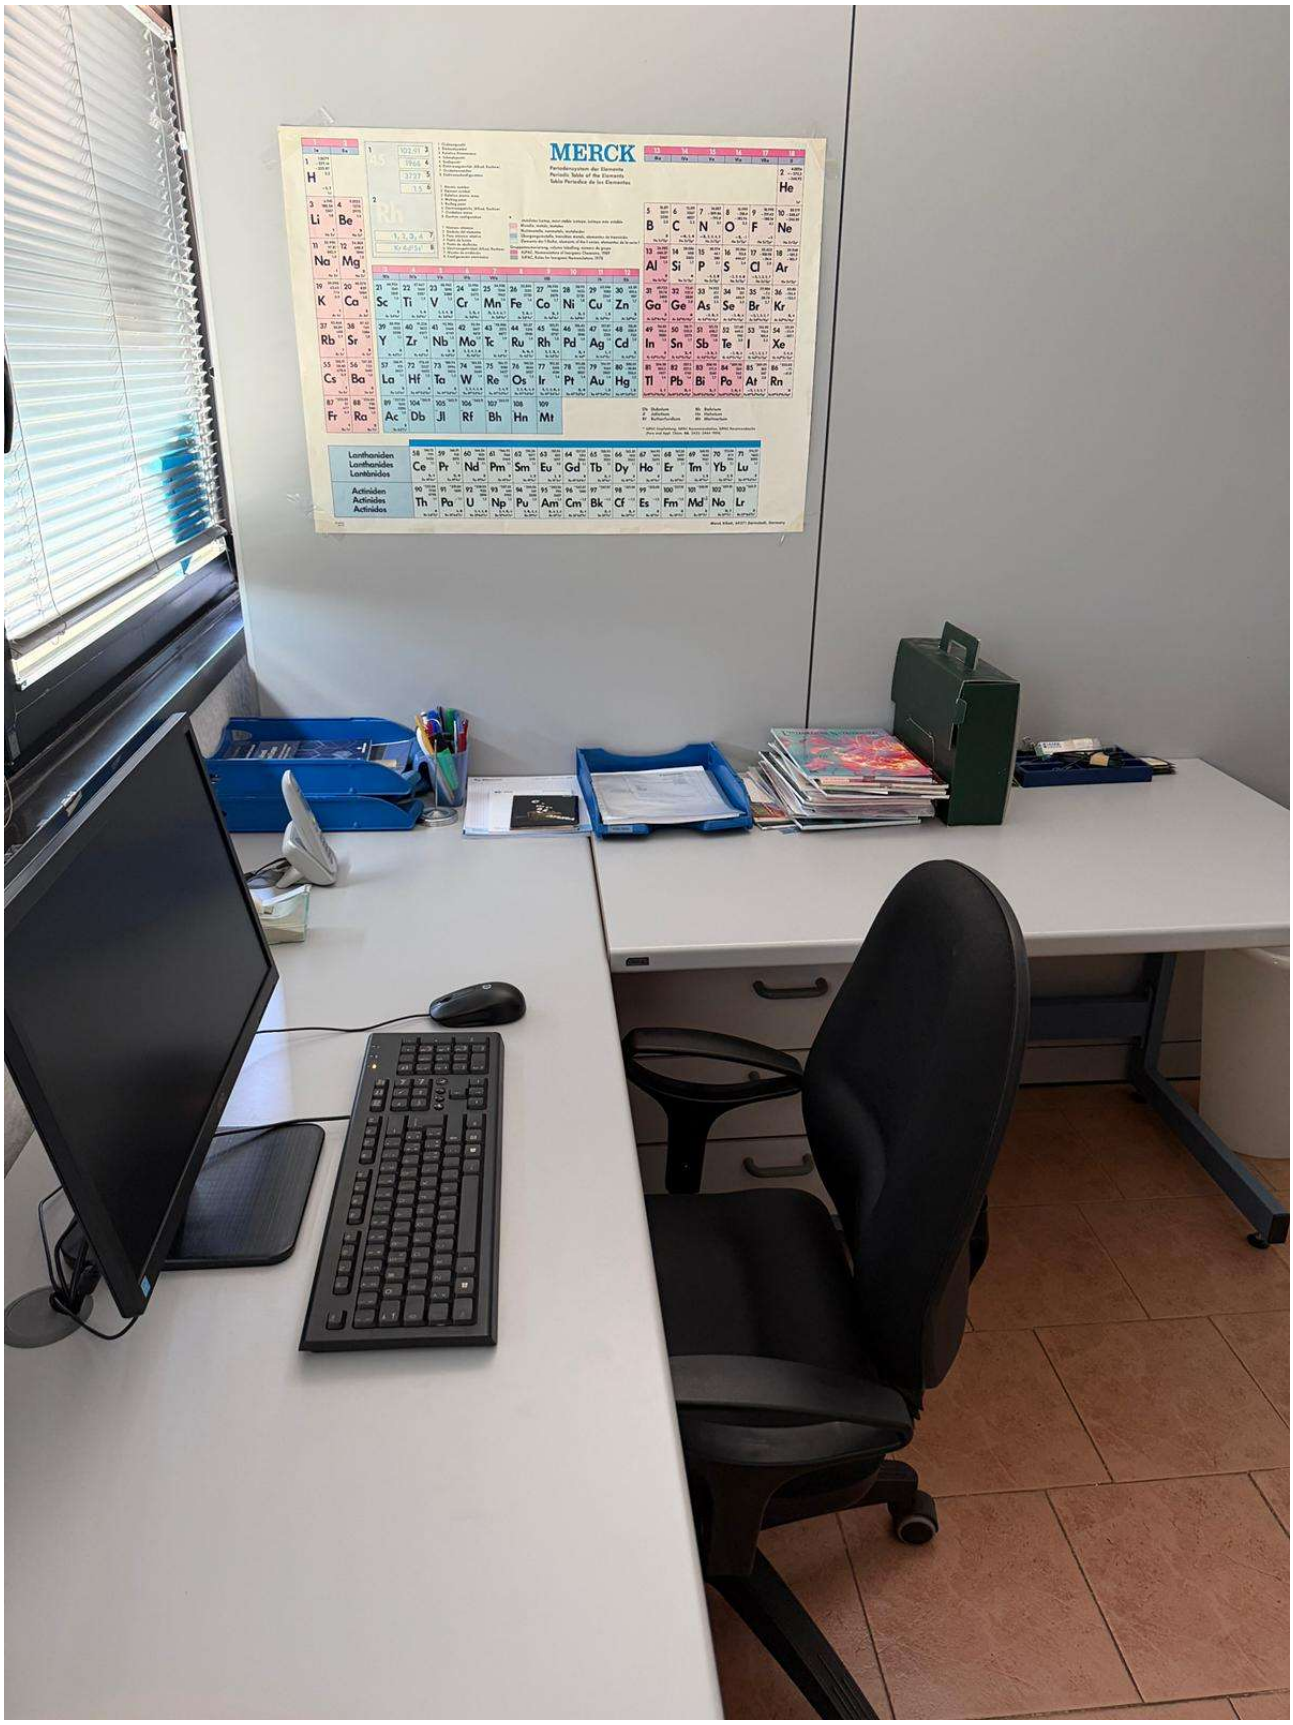
MERCK

APRILE
MAGGIO
GIUGNO
indena

IMPULSE SEALER

BINDER

asoltech

VIETATO
BERE E
MANGIARE

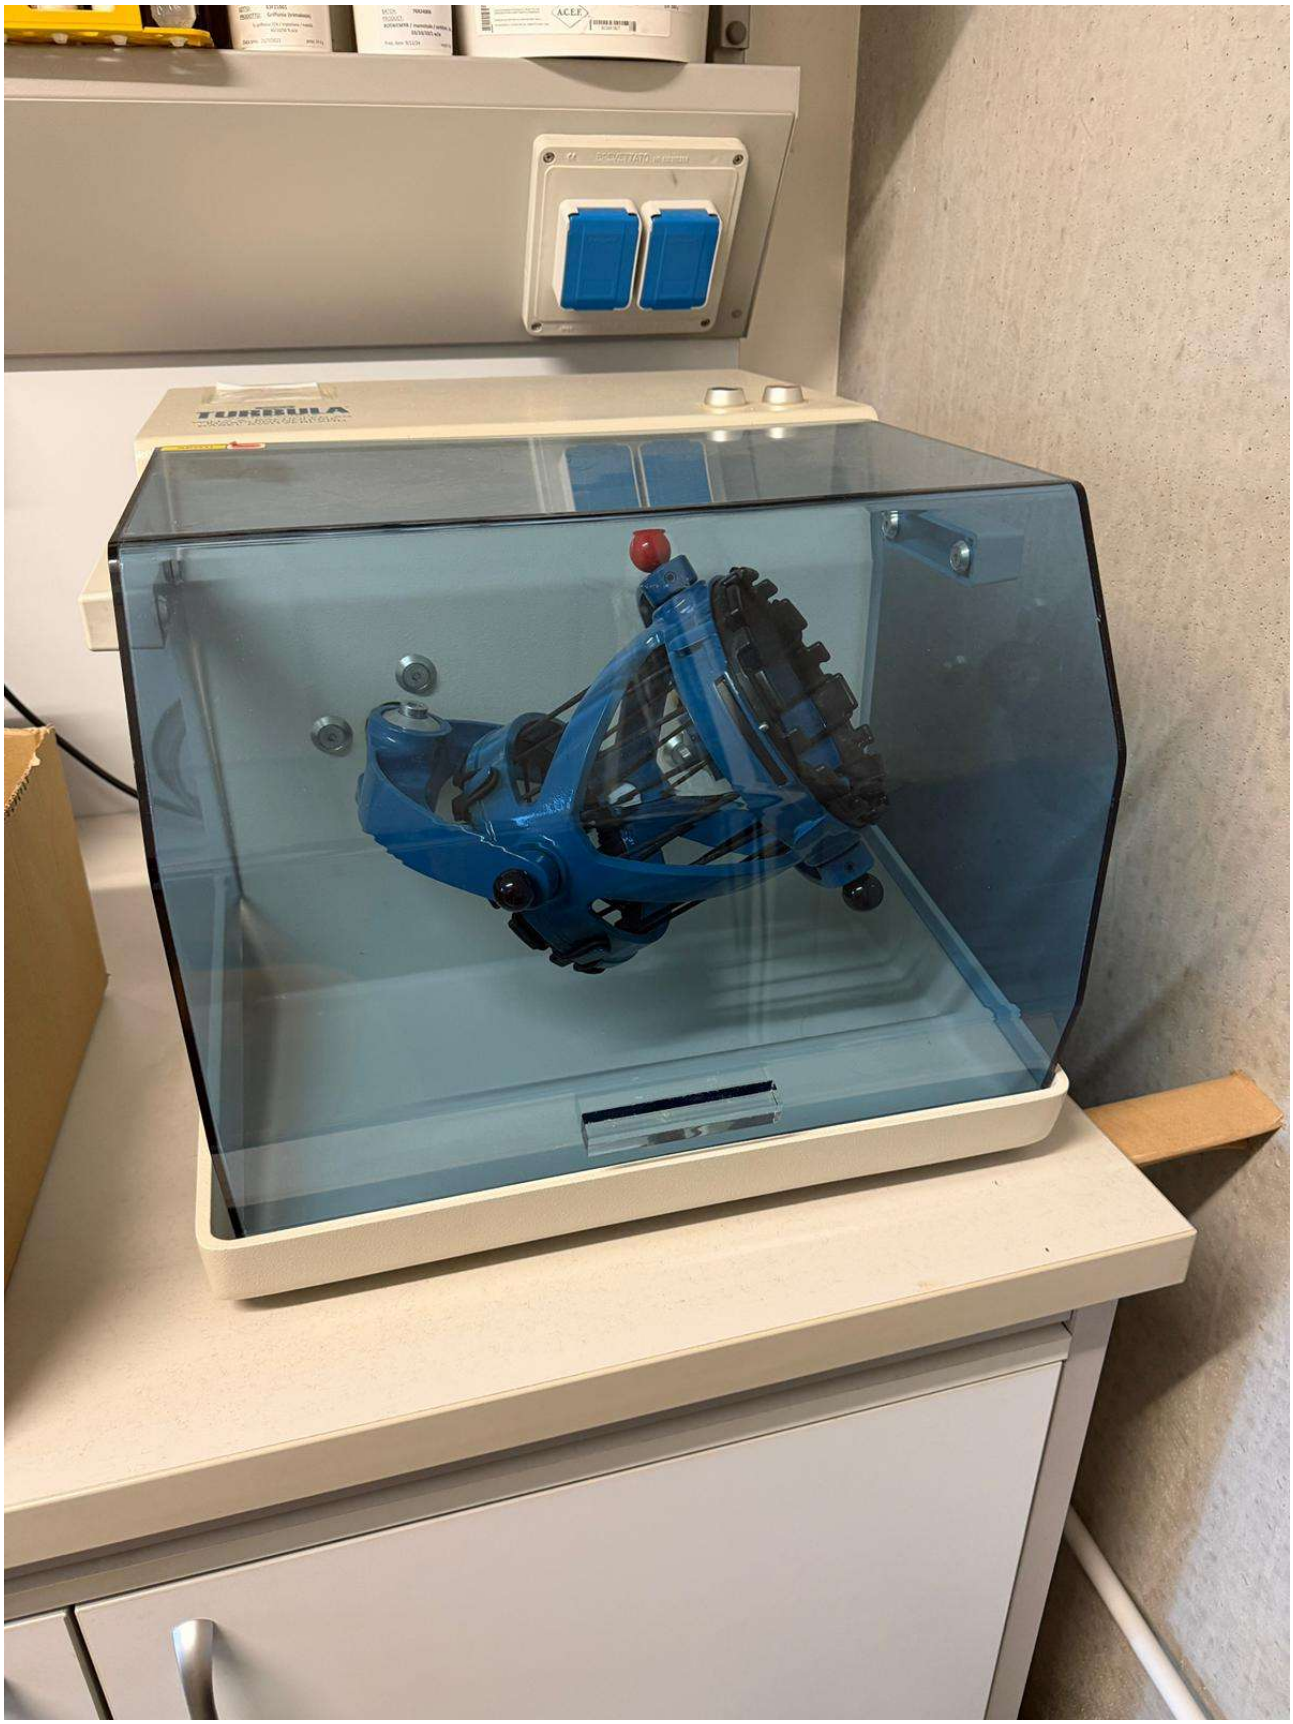

eurociima

euroclima

SE014
2018
Check
Standby
Prog
Reset
I. ENGELSMANN AG